

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

8-Draht Impedanzstabilisierungsnetzwerk CAT5 8158 8-Wire Impedance Stabilisation Network CAT5 8158



Technische Daten		Specification
Frequenzbereich:(ISN)	150 kHz – 30 MHz	<i>Frequency range (ISN):</i>
Frequenzbereich (CDN)	150 kHz – 80 MHz	<i>Frequency range (CDN):</i>
Typ:	T8, T4, T2-ISN, CDN (EAB8 50-150 required)	<i>Type:</i>
Einfügedämpfung für Nutzsignal Gegentakt AE - EuT Port:	typ.: < 1 dB 100 kHz to 30 MHz typ.: < 2.5 dB 30 MHz to 250 MHz (Fig.1)	<i>Insertion loss: differential mode AE - EuT port:</i>
Entkopplungsdämpfung AE – EuT	>55 dB (Fig.2)	<i>Decoupling AE-EuT:</i>
Unsymmetriedämpfung (LCL)	65 dB @ 150 kHz 49 dB @ 30 MHz (Fig.3)	<i>Longitudinal Conversion Loss (LCL):</i>
Spannungsteilung für asymmetrische Störspannung	9.5 dB ± 1 dB (Fig.4)	<i>Voltage division factor for asymmetrical voltage:</i>
max. HF Spannung EUT:	15 V	<i>max. RF-voltage EuT:</i>
max. HF Spannung Messanschluss (BNC)	25 V	<i>max. RF-voltage measurement port (BNC):</i>
Impedanz asymmetrisch:	≤30 MHz: 150 Ω ± 20 Ω (Fig.5a) >30 MHz: 150 Ω +60 Ω/ -45 Ω≤	<i>Impedance (asymm.):</i>
Phasengang:	0° ± 20° (Fig.5b)	<i>Common mode phase angle:</i>
Anschlüsse AE, EuT:	RJ-45 socket	<i>Connectors AE, EuT:</i>
Strombelastbarkeit Line:	800 mA DC (pair)	<i>Current max:</i>
Spannungsfestigkeit:	63 VAC / 100 VDC	<i>Max. voltage:</i>
Messtor:	BNC 50 Ω female	<i>Measurement port:</i>
Entferntes Übersprechen PSELFEXT:	typ.: >66 dB 150 kHz – 1 MHz typ.: >46 dB at 10 MHz typ.: >38 dB at 30 MHz	<i>Crosstalk PSELFEXT:</i>
Gewicht:	465 g	<i>Weight:</i>
Außenabmessungen B x H x T:	125 mm x 62 mm x 105 mm	<i>Outer dimensions W x H x D:</i>
CISPR Schaltbild:	CISPR 22, Appendix D, Fig. D.3	<i>CISPR Circuits:</i>

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

8-Draht Impedanzstabilisierungsnetzwerk CAT5 8158 8-Wire Impedance Stabilisation Network CAT5 8158

Beschreibung:

Mit dem Impedanzstabilisierungsnetzwerk (ISN) CAT5 8158 können asymmetrische Störspannungsmessungen an ungeschirmten symmetrischen Leitungen (UTP) bzw. Kommunikationsschnittstellen mit 2, 4, 6 oder 8 Adern entsprechend den Produktnormen CISPR 22:2005 bzw. EN 55022:2006 durchgeführt werden. Der Anschluss von Prüflingen, Netzwerken oder Hilfsgeräten erfolgt über RJ-45 Buchsen mit der genormten Steckerbelegung nach EIA/TIA-T568A/B. Das Schaltbild der CAT5 8158 entspricht CISPR 22 Edition 5.2, Abbildung D.3.

Das ISN CAT5 8158 besitzt auf der Prüflingsseite (EuT = Equipment under Test) eine in engen Toleranzen eingestellte Unsymmetriedämpfung (LCL = Longitudinal Conversion Loss) von 65 dB, wodurch Messungen entsprechend der Kabelkategorie CAT5 möglich sind. Für Messungen an CAT6 Systemen wird die NTFM 8158 angeboten und für Messungen an CAT3 Systemen ist die CAT3 8158 erhältlich.

Neben Störaussendungsmessungen sind auch Störfestigkeitsmessungen bis 80 MHz (nach CISPR 24 bzw. EN 55024) möglich. Dazu wird ein 50 Ω auf 150 Ω Adapter EAB8 50 – 150 nach IEC 61000-4-6 benötigt, der als Modul an die CAT5 8158 angesteckt werden kann. Dieser Adapter ist optional erhältlich.

Die Spezifikationen der CAT5 8158 werden gemäß CISPR 16-1-2, Annex E vermessen und erfüllen alle Anforderungen aus CISPR 22 Ed. 5.2.

Anwendung:

Der Telekommunikationsanschluss des Prüflings wird an die EuT-Seite angeschlossen. Die CAT5 8158 stellt damit die asymmetrische Leitungsabschlussimpedanz des Prüflings dar. Hilfsgeräte oder Zusatzeinrichtungen, die mit dem Prüfling betrieben werden müssen, werden an den Anschluss AE (=Auxiliary Equipment) angeschlossen.

Die Übertragung von Daten erfolgt durch symmetrische Nutzsignale auf Leitungspaaren. Verschiebt sich der virtuelle Nullpunkt eines

Description:

The ISN CAT5 8158 allows to perform common mode disturbance voltage measurements on unshielded twisted pairs (UTP) or communication ports with 2, 4, 6 or 8 wires according to CISPR 22:2005 or EN 55022:2006. The Equipment under Test (EuT) or Auxiliary Equipment (AE) can be connected using the RJ-45 sockets. The pin assignment follows EIA/TIA-T568A/B. The electrical circuit of CAT5 8158 is designed according to CISPR 22 Edition 5.2, figure D.3.

The ISN-device CAT5 8158 provides an longitudinal conversion loss of typically 65 dB at the EuT port and allows to measure CAT5 devices. There are two further ISN available for measurements of CAT3 devices (CAT3 8158) and CAT6 devices (NTFM 8158) respectively.

In addition to the measurement of disturbance voltage the CAT3 8158 allows to perform measurements of conducted immunity acc. CISPR 24 or EN 55024 up to 80 MHz. An additional 50 Ω to 150 Ω adapter (EAB8 50-150) acc. IEC 61000-4-6 is required. This adapter can easily be mounted to CAT5 8158 and is available as an option.

The specification of CAT5 8158 is fully compliant to CISPR 22 Ed. 5.2 and verified according methods described in CISPR 16-1-2, Annex E.

Application:

The telecommunication port of the Device under Test must be connected to the CAT5 8158 EuT-port. The CAT5 8158 provides the asymmetrical port termination of the EuT. Auxiliary Equipment (AE) which has to be operated together with the device under test must be connected to the AE-port of CAT5 8158.

The data communication is based on differential mode voltages on pairs of wires. If the virtual null in the electrical middle of the

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

8-Draht Impedanzstabilisierungsnetzwerk CAT5 8158 *8-Wire Impedance Stabilisation Network CAT5 8158*

Leitungspaars gegen Bezugsmasse, spricht man von asymmetrischer Störspannung oder Gleichtaktstörung. Diese werden an die BNC Buchse der CAT5 8158 ausgekoppelt. Das nominelle Spannungsteilungsmaß beträgt dabei ca. 9.5 dB. Die mit einem 50 Ω Messempfänger angezeigte Spannung muss also um 9.5 dB erhöht werden, um die Störspannung zu errechnen.

Die Unsymmetriedämpfung beschreibt, in welchem Maß das differentielle (Gegentakt-) Nutzsignal der Datenübertragung entlang einer Übertragungsleitung in ein (unerwünschtes) Gleichtakt-Signal umgewandelt wird. Gleichtaktsignale können abgestrahlt werden und daher Störungen verursachen.

Details zum Prüfaufbau sind in CISPR 22 bebildert und beschrieben. Besondere Beachtung ist dabei induktivitätsarmer, d.h. hochfrequenzmäßige niederohmiger Verbindung mit der Bezugsmassefläche zu schenken. Dies wird durch direktes, flächiges Auflegen des Aluminiumgehäuses der CAT5 8158 auf die Bezugsmassefläche erreicht. AE- und EuT-Kabel dürfen nicht parallel geführt werden, um die gute Entkopplung der CAT5 8158 zu erhalten.

Anschlussbelegung:

Die Steckerbelegung erfolgt nach EIA/TIA-T568A/B. RJ-12 und RJ-14 Stecker verwenden Paar 1 und Paar 3, RJ-11 Stecker verwenden Paar 1, da diese in der RJ-45 Buchse in der Mitte liegen, wobei Pin 1 und 6 des RJ-12 Steckers nicht benutzt werden können. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der RJ-45 Buchse bei Verwendung von RJ-12-, RJ-11- oder RJ-14 Steckern erheblich abnimmt.

Wird an weniger als 4 Leitungspaaren gemessen, werden die unbenutzten Adern freigelassen.

voltages shifts compared to reference ground the magnitude of this shift is called the asymmetrical disturbance voltage or the common mode voltage. This voltage is coupled out to the BNC-connector to be measured with a receiver. The nominal voltage division factor is 9.5 dB, i.e. the reading of the voltage at a 50 Ω receiver has to be increased by 9.5 dB. The result is the disturbance voltage.

The LCL describes the conversion of the wanted differential mode data signal along a transmission line into an unwanted common mode signal. The common mode signal could be radiated and might cause disturbance field strength.

The test set up is described in CISPR 22 more detailed. Special attention must be paid to low inductive grounding, i.e. grounding suitable for radio frequencies. This is achieved by placing the aluminium housing of CAT5 8158 directly on the reference ground plane. The EuT cable and the AE cable must not be installed close or parallel to each other to avoid unwanted coupling between them.

Pin assignment:

The Pin Assignment complies to EIA/TIA-T568A/B. RJ-12 and RJ-14 connectors use pair 1 and pair 3, RJ-11 connectors use pair 1 of the RJ-45 jack which are located in the middle of the RJ-45 connector. Pins 1 and 6 of the RJ-12 are not useable then. Please note that using RJ-12, RJ-11 or RJ-14 connectors in RJ-45 jacks leads to decreased lifespan of the RJ-45 jack.


If less than four pairs are measured, the unused wires are left unconnected.

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK


An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

8-Draht Impedanzstabilisierungsnetzwerk CAT5 8158 8-Wire Impedance Stabilisation Network CAT5 8158


Paar/ <i>pair</i>	RJ-45 connector	RJ-12/RJ-14 connector	RJ-11 connector
1	Pin 4+5	Pin 3+4	Pin 3+4
2	Pin 1+2	-	
3	Pin 3+6	Pin 2+5	
4	Pin 7+8	-	




RJ-45/RJ-48/RJ-61 - 8P8C



RJ-12 - 6P6C



RJ-14 - 6P4C



RJ-11 - 6P2C

8-Draht Impedanzstabilisierungsnetzwerk CAT5 8158 8-Wire Impedance Stabilisation Network CAT5 8158

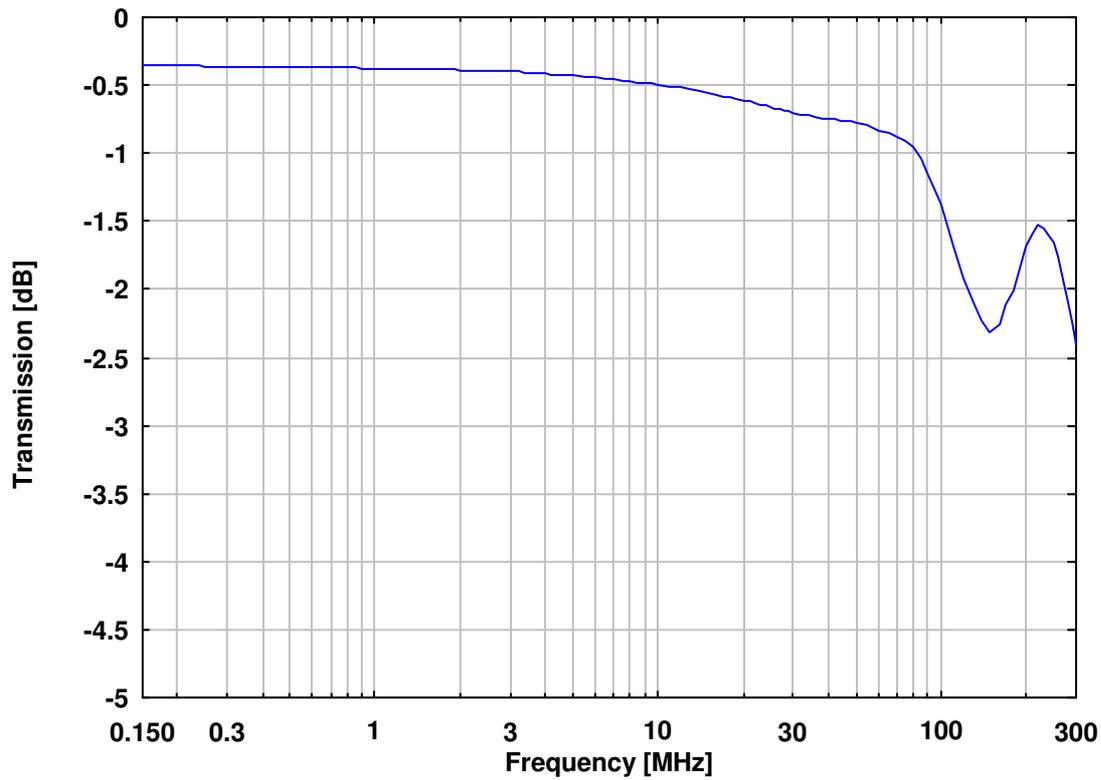


Fig. 1 Transmission Differential Mode Signal AE-EuT

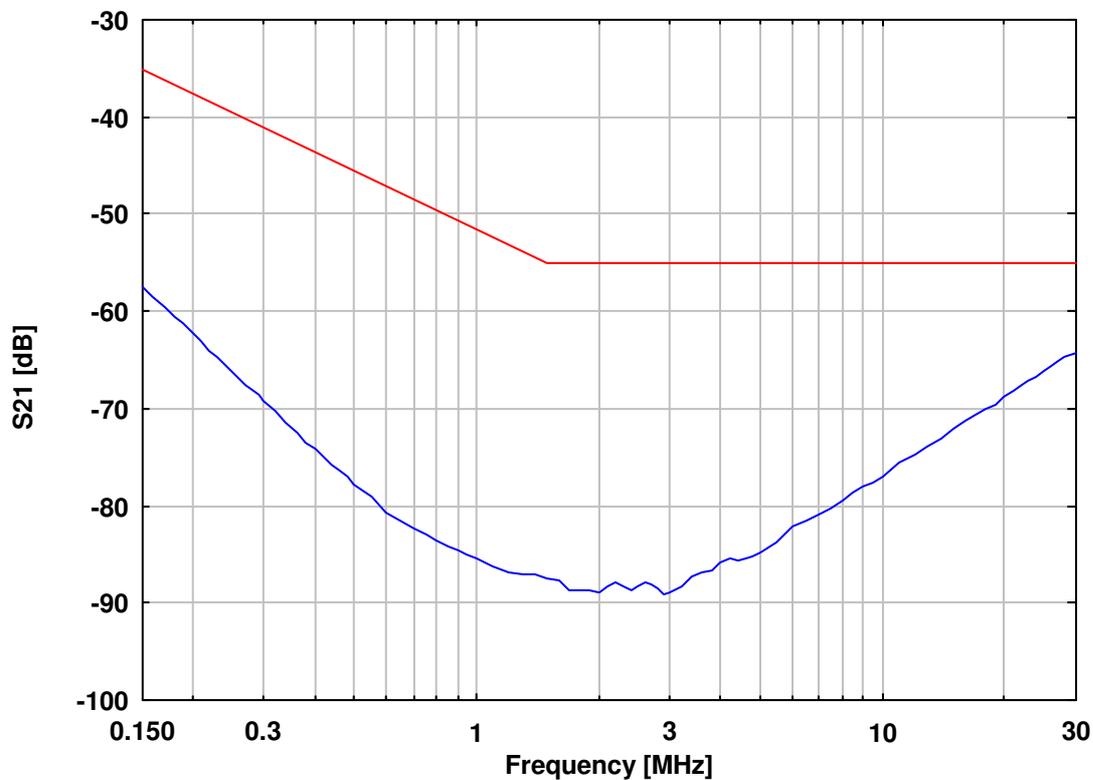


Fig.2 Decoupling AE - EuT (red line: CISPR limit)

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

8-Draht Impedanzstabilisierungsnetzwerk CAT5 8158 8-Wire Impedance Stabilisation Network CAT5 8158

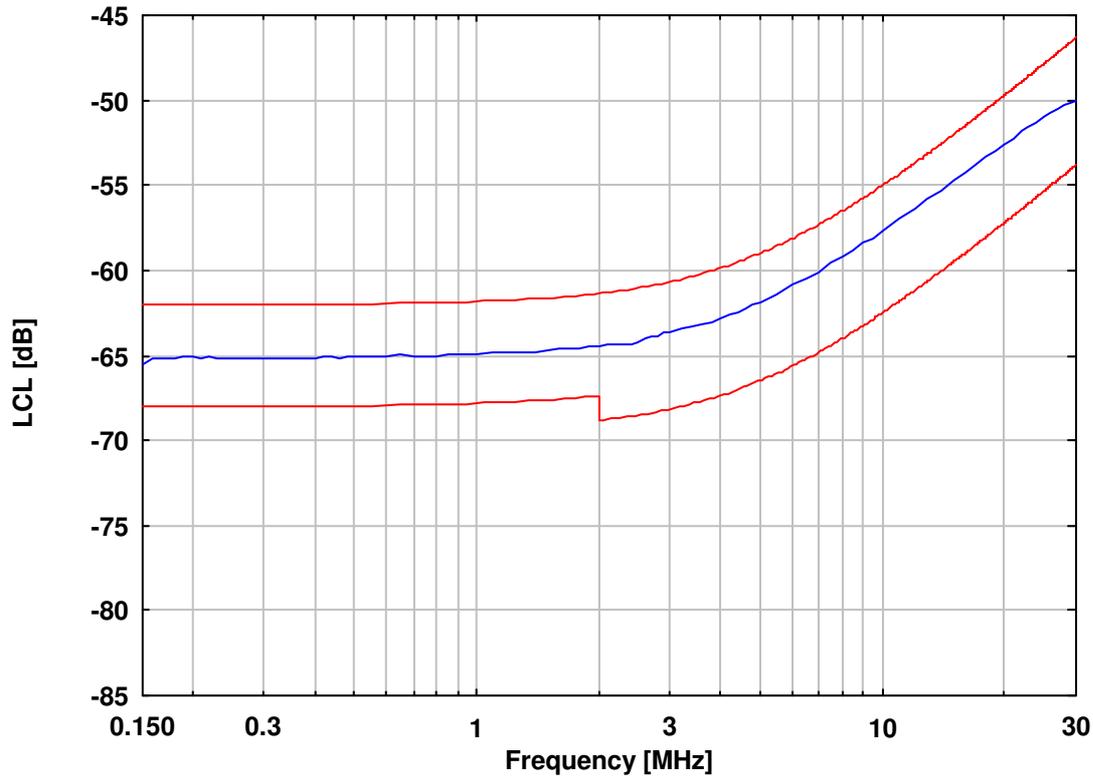


Fig.3 Typical Longitudinal Conversion Loss (LCL) (red lines: CISPR limits)

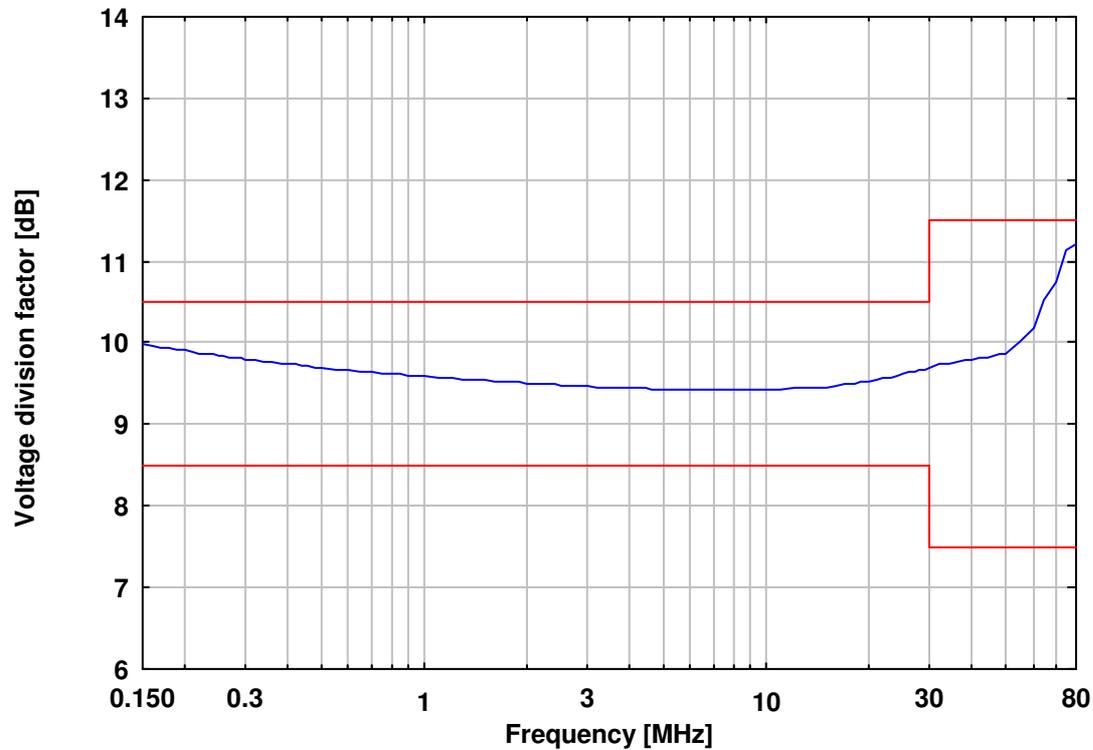


Fig.4 Transmission EuT to Measurement Port (red lines: CISPR limits)

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

8-Draht Impedanzstabilisierungsnetzwerk CAT5 8158 8-Wire Impedance Stabilisation Network CAT5 8158

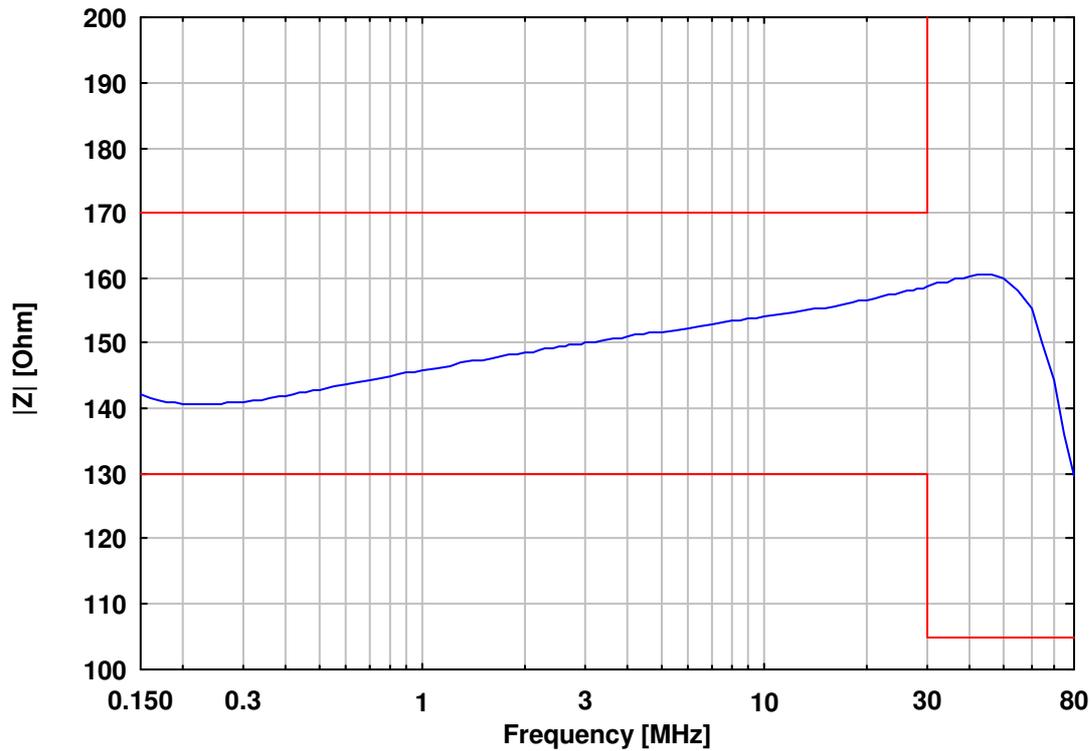


Fig.5a Common Mode Impedance (Magnitude) at EuT-Terminals (red lines: CISPR limits)

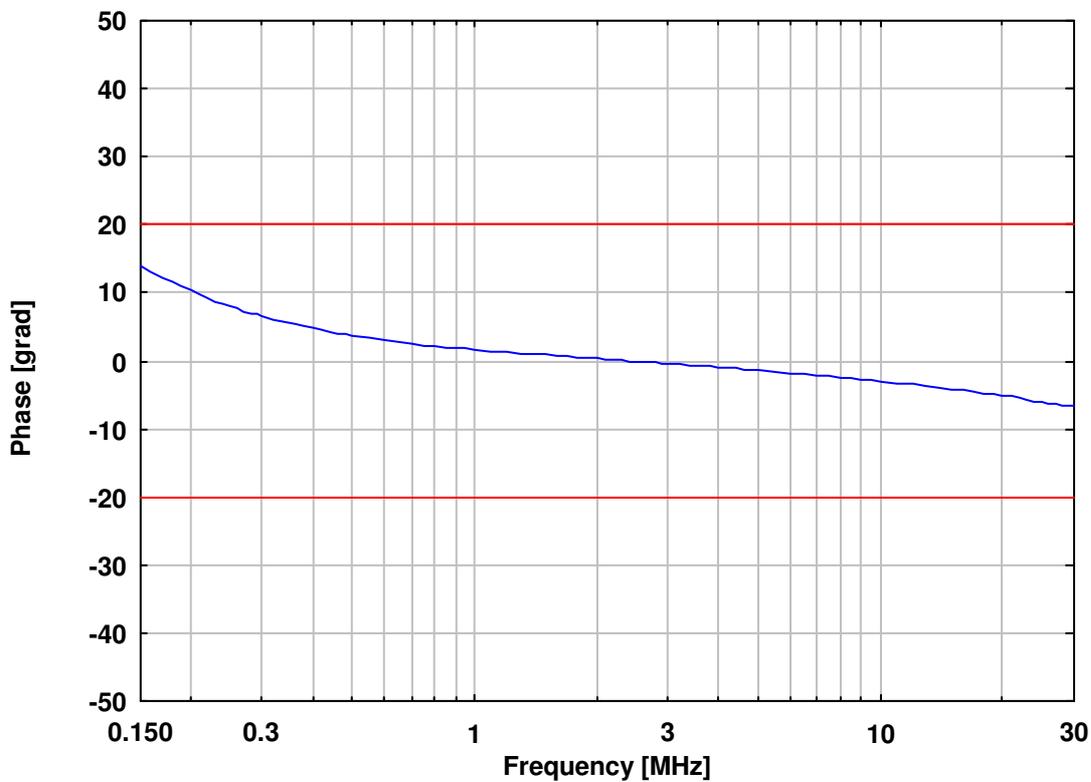


Fig.5b Common Mode Impedance (Phase) at EuT-Terminals (red lines: CISPR limits)